


DPI100

Manômetro Digital de Alta Exatidão

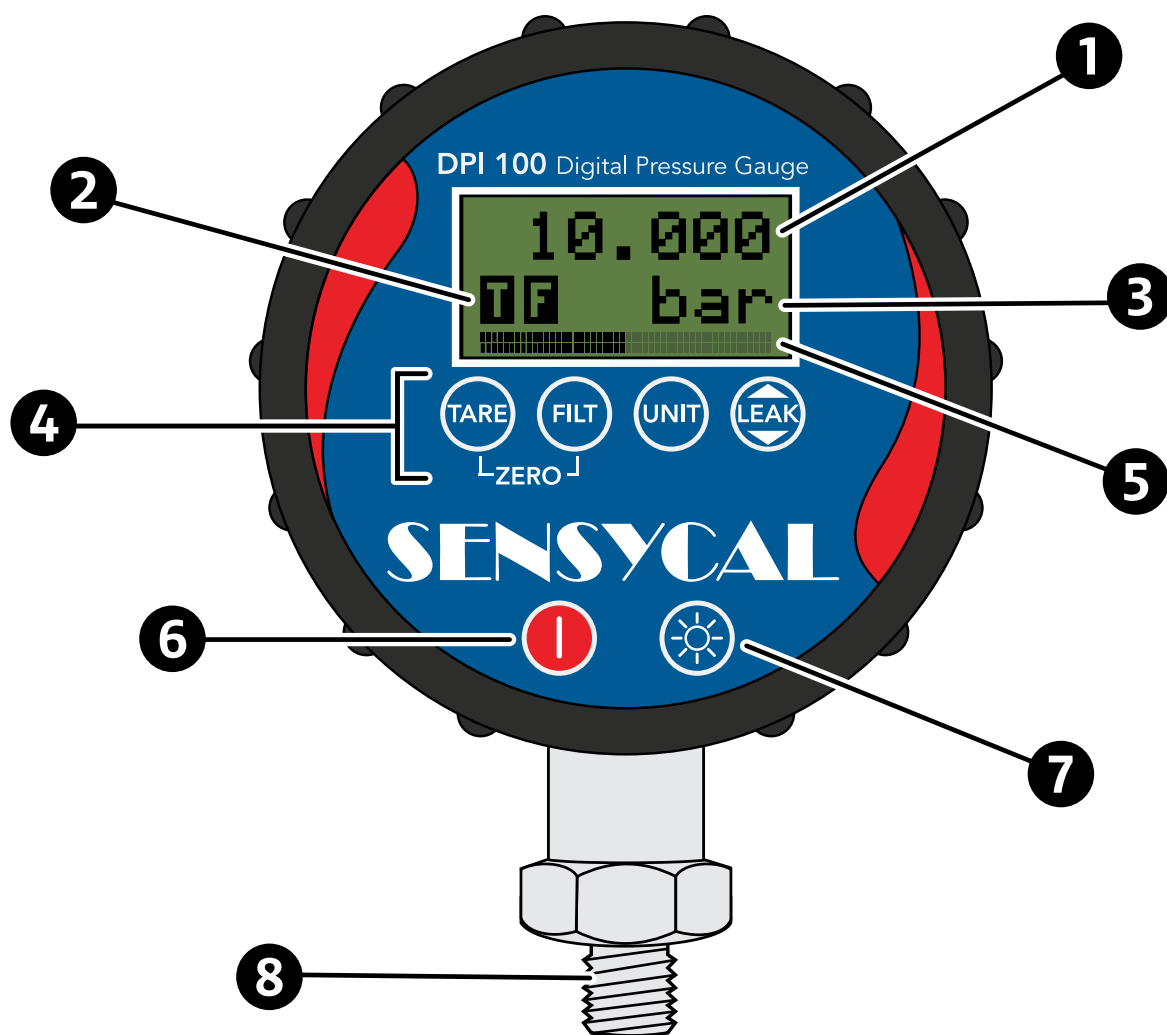

Item	Descrição	Item	Descrição
1	Medição de pressão/temperatura	5	Bar graph/gráfico de barras
2	Ícones de função e status	6	Botão de liga/desliga
3	Unidade de pressão/temperatura	7	Botão de luz de fundo
4	Botões de operação	8	Conexão de pressão

Guia de Início Rápido

GIR-DE-0001 PT-BR REV. 06

© Sensycal Instrumentos e Sistemas Ltda.

Sequência de inicialização

1s
ligar DPI 100



Identificação do fabricante

SENSYCAL

Identificação do produto

DPI 100

Identificação do
limite superior

▲ 20.00
9 bar

Identificação do
limite inferior

▼ -1.00
9 bar

Ativar tara

Leitura de pressão

3.500
TF bar

Ativar tara



Leitura de pressão
após tara ser ativada

0.000
TF bar

Mudar variável

Tela de medição com
leitura de pressão

3.500
TF bar

Modificar
variável



Tela de medição com
leitura de temperatura

25.0
°C

Mudar unidade

Leitura de pressão
em bar

3.500
TF bar

Modificar
unidade



Leitura de pressão
em mbar

3500
TF mbar

Ativar filtro

Leitura de pressão
sem filtro

2.405
TF bar


Ativar filtro



Leitura de pressão
com filtro

2.405
TF bar


Máximo e mínimo

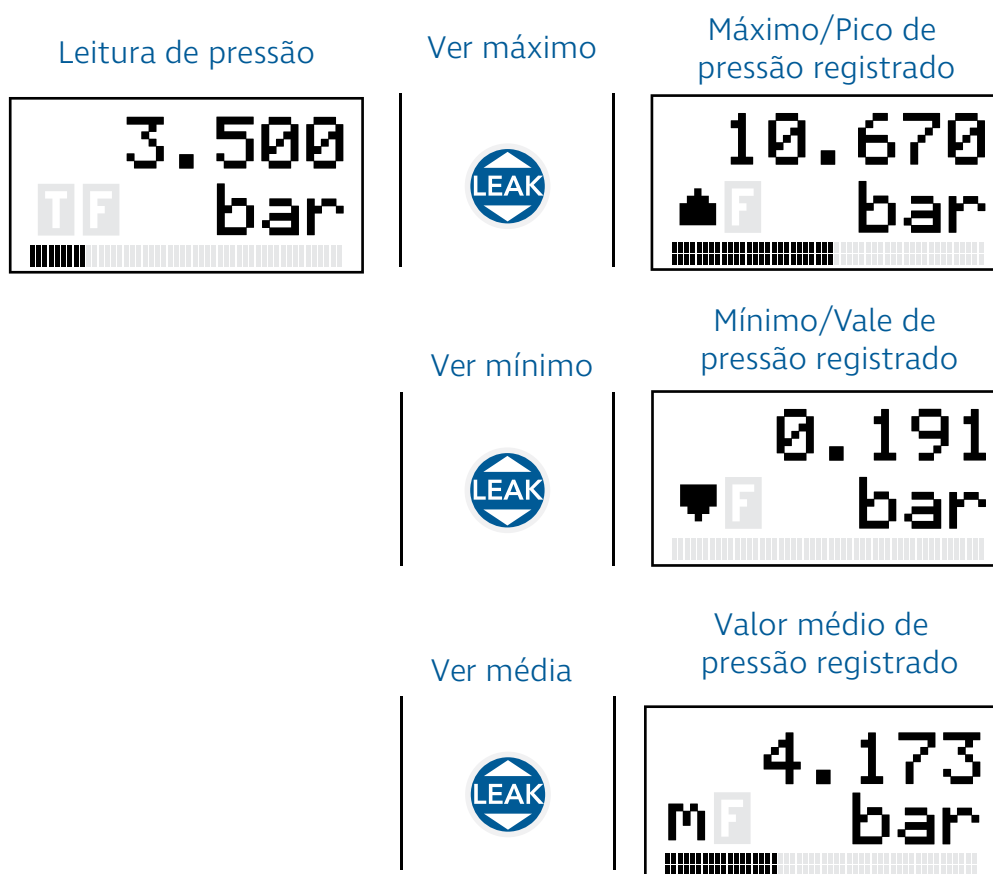

Teste de vazamento



Configurações

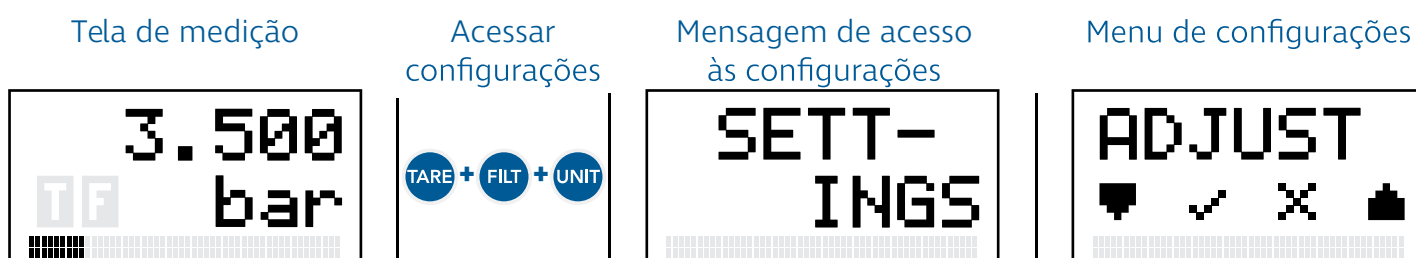

Segurança

Antes de instalar e operar o DPI100, leia e entenda todas as informações relevantes. Isso inclui todos os protocolos de segurança do local de trabalho, normas de segurança gerais, e o manual de usuário.

O DPI100 deve ser utilizado apenas por profissionais qualificados. O usuário é responsável pelo transporte, armazenamento, instalação, operação e manutenção do manômetro.

Para mais informações sobre os limites de funcionamento do DPI100 e procedimentos de manutenção, veja as seções "Especificações" e "Manutenção" no manual do produto.

Para prevenir incêndios, explosões e lesões:

- **Utilize o produto apenas como especificado no manual.**
- **Não realize alterações no produto fora do escopo definido pelo manual. Isso irá invalidar a garantia do produto e poderá causar danos aos usuários e ao produto.**
- **A substituição de componentes pode comprometer o funcionamento do produto e causar lesões ao usuário.**
- **Não utilize o produto se ele operar de forma incorreta.**
- **Não utilize o produto se ele estiver alterado ou danificado.**
- **Se o produto for colocado em uma situação fora de seus limites de segurança, verifique se houve algum dano ao produto. Se necessário, retorne o produto para a Sensycal para análise e reparo.**
- **Evite qualquer ação que possa gerar uma carga eletrostática. Descargas eletrostáticas podem gerar explosões.**
- **Não abra o compartimento de baterias em atmosferas explosivas. Isso pode causar uma explosão.**
- **Baterias podem causar faíscas incendiárias. Instale ou troque baterias apenas em áreas seguras.**

